


VERIFICATION DU CONTROLE QUALITE ANABOLISANT

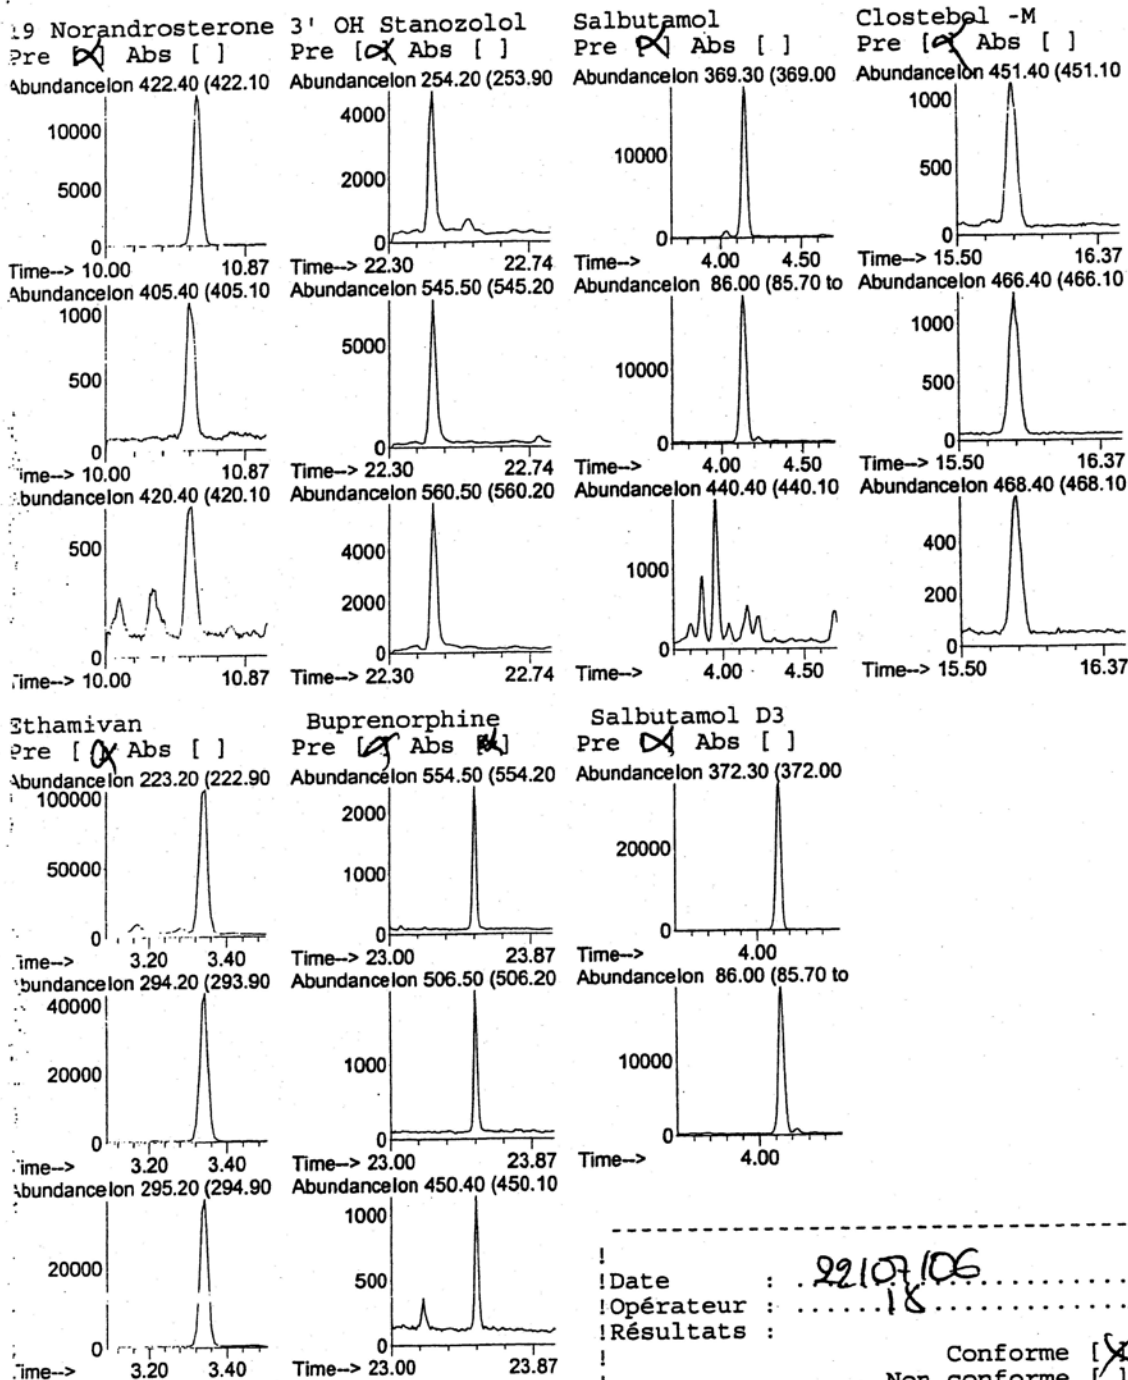

Date : 22/07/06
 Opérateur : [Signature]
 Résultats :
 Conforme
 Non conforme []
 Remarques : OK E